

**Sede Legale:**  
Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 Genova  
**Dati societari:**  
C.C.I.A.A. Genova n. 289645  
Codice Fiscale: IT 02687740106  
Partita I.V.A.: IT 02687740106  
SDI: SUBM70N  
Capitale Sociale interamente versato: €  
90.000


**SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE S.r.l.**



INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

**Amministrazione e Uffici:**  
Via Renata Bianchi 38/5 - 16152 Genova  
**Laboratori:**  
Via Castel Morrone, 15 H - 16161 Genova  
**Contatti:**  
Tel.: 010 7406583 - Fax: 010 7406584  
E-mail: [segreteria@sige.ge.it](mailto:segreteria@sige.ge.it)  
Sito web: [www.sige.ge.it](http://www.sige.ge.it)

Genova, 10/01/2024

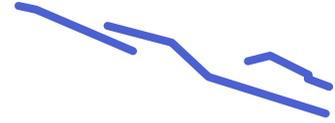

## NUOVA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA

(Codice Perizia 3062)

(condizione ambientale n.5 del parere 233 del 28 marzo 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS)

**COMPARTO AMBIENTE**

**MONITORAGGIO FASE CORSO D'OPERA**

**RAPPORTO ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE**

**Componente RUMORE**

Stazione di monitoraggio rumore

**P3062\_II2023\_RUM\_08**

Polizia Locale – Unità Territoriale Centro – sede Portoria 32° – Piazza Ortiz

**Gennaio 2024**

Rev.	Date/ Data	Modifiche	Redatto da	Controllato da	Autorizzato da
0	10/01/2024	Prima emissione	Alessandro Altomari TCA (ENTECA n.11821) (SIGE S.r.l)	Francesca Tarchino (SIGE S.r.l)	Francesca Tarchino (SIGE S.r.l)
1	20/05/2024	Inserimento confronto con soglie di riferimento	Christian Roggerone (SIGE S.r.l)	Francesca Tarchino (SIGE S.r.l)	Francesca Tarchino (SIGE S.r.l)

IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA		
Codice della Stazione	P3062_I12023_RUM_08 – Polizia Locale – Unità Territoriale Centro – sede Portoria 32° – Piazza Ortiz	
Campagna	Corso d'opera	
Data e ora inizio misura	13/11/2023 09:37	
Data e ora fine misura	14/11/2023 09:49	
Tipo di ricevitore	Edificio che ospita uffici pubblici	
Ubicazione	Piazza Fernando Ortiz, 8, 16128 Genova	
Coord. UTM EDS0 ZONE 32N	494568 E	4916563 N
note	--	


DESCRIZIONE DELL'AREA		
Area urbana con intensa attività umana. Presenza di importanti infrastrutture di comunicazione e portuali.		
SORGENTI		
Sorgenti	Identificazione	Tipologia
Rumore d'area	Rumore d'area	casuale
Viabilità urbana	Traffico veicolare	casuale
DESCRIZIONE DEL RECETTORE		
L'edificio ospita una delle sedi distaccate della Polizia Locale.		

CATENA DI MISURA		
Strumentazione	Marca e Modello	Certificato di Taratura LAT
Fonometro	Brüel&Kjær Tipo 2250	LAT213 23-091-0-SLM
Preamplificatore	Brüel&Kjær ZC 0032	LAT213 23-091-0-SLM
Microfono	Brüel&Kjær 4189	LAT213 23-091-0-SLM
Calibratore	HD 2020	LAT213 23-094-0-SSR
Programma di analisi	Brüel&Kjær Evaluator®	n.a.
Calibrazione	Prima e dopo la esecuzione delle misure si è proceduto con la calibrazione della catena di misura.	

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE

<https://mappe.comune.genova.it/MapStore2/#/viewer/openlayers/34>

## Ortofoto

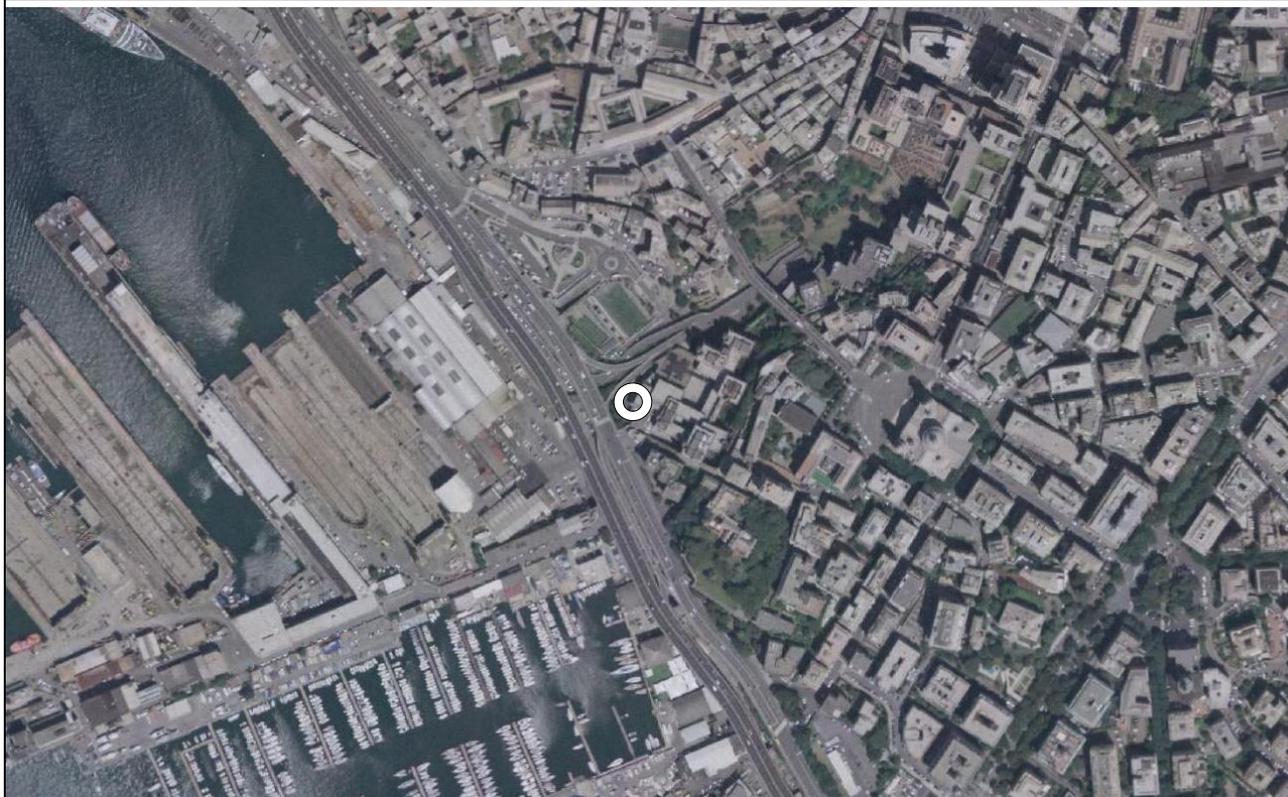

## Stralcio planimetrico



## Classificazione Acustica



Classificazione acustica		Valori limite, dB(A)			
		Periodo diurno		Periodo notturno	
Classe	Descrizione	immissione	emissione	immissione	emissione
I	Aree particolarmente protette	50	45	40	35
II	Aree prevalentemente residenziali	55	50	45	40
III	Aree di tipo misto	60	55	50	45
IV	Aree di intensa attività umana	65	60	55	50
V	Aree prevalentemente industriali	70	65	60	55
VI	Aree esclusivamente industriali	70	65	70	65

REPERTORIO FOTOGRAFICO

Ricevitore



## REPERTORIO FOTOGRAFICO

### Disposizione della catena di misura



### Localizzazione del microfono


<b>Posizione</b>	Disposizione verticale del microfono, assenza di superfici riflettenti nelle immediate vicinanze
<b>Altezza</b>	4 m circa dal piano di calpestio del terrazzo dell'edificio recettore

RISULTATI DELLE MISURE											
Ora inizio	Ora termine	Durata hh:mm	La <sub>eq</sub> [dB]	LAF <sub>max</sub> [dB]	LA <sub>1</sub> [dB]	LA <sub>10</sub> [dB]	LA <sub>50</sub> [dB]	LA <sub>90</sub> [dB]	LA <sub>95</sub> [dB]	LA <sub>99</sub> [dB]	LAF <sub>min</sub> [dB]
13/11/2023 10:00:00	13/11/2023 11:00:00	1:00:00	69,0	85,0	73,4	70,3	68,6	67,3	67,1	66,3	63,0
13/11/2023 11:00:00	13/11/2023 12:00:00	0:00:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13/11/2023 12:00:00	13/11/2023 13:00:00	0:00:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13/11/2023 13:00:00	13/11/2023 14:00:00	0:00:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13/11/2023 14:00:00	13/11/2023 15:00:00	0:00:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13/11/2023 15:00:00	13/11/2023 16:00:00	0:00:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13/11/2023 16:00:00	13/11/2023 17:00:00	1:00:00	69,7	91,8	80,4	69,8	68,7	67,6	67,3	66,6	63,5
13/11/2023 17:00:00	13/11/2023 18:00:00	1:00:00	69,7	92,3	79,4	70,3	68,8	67,1	66,6	66,1	62,5
13/11/2023 18:00:00	13/11/2023 19:00:00	1:00:00	72,8	94,2	82,4	78,0	67,9	66,4	66,1	65,3	60,5
13/11/2023 19:00:00	13/11/2023 20:00:00	1:00:00	69,4	94,5	80,4	69,3	67,8	66,4	66,2	65,6	61,3
13/11/2023 20:00:00	13/11/2023 21:00:00	1:00:00	66,1	74,7	68,4	67,7	65,9	64,3	64,0	62,6	57,1
13/11/2023 21:00:00	13/11/2023 22:00:00	1:00:00	64,3	79,7	67,7	65,6	64,2	62,5	62,2	61,6	55,5
13/11/2023 22:00:00	13/11/2023 23:00:00	0:59:00	64,0	79,0	66,4	65,0	64,0	62,6	62,0	61,2	55,9
13/11/2023 23:00:00	14/11/2023 00:00:00	1:00:00	64,4	76,7	66,9	66,0	64,3	62,5	62,2	62,0	55,9
14/11/2023 00:00:00	14/11/2023 01:00:00	1:00:00	62,6	76,1	65,8	64,5	62,6	59,7	58,8	58,2	50,4
14/11/2023 01:00:00	14/11/2023 02:00:00	1:00:00	59,1	73,0	63,4	62,0	58,6	55,0	53,5	52,3	48,0
14/11/2023 02:00:00	14/11/2023 03:00:00	1:00:00	57,7	75,9	63,4	60,8	56,2	53,0	52,0	50,3	45,7
14/11/2023 03:00:00	14/11/2023 04:00:00	1:00:00	58,6	77,1	65,4	62,5	57,0	53,8	53,2	50,6	46,9
14/11/2023 04:00:00	14/11/2023 05:00:00	1:00:00	60,3	75,5	66,4	63,0	60,1	55,3	54,0	53,2	47,3
14/11/2023 05:00:00	14/11/2023 06:00:00	1:00:00	62,1	76,4	65,7	64,4	62,1	57,8	57,0	54,6	49,5
14/11/2023 06:00:00	14/11/2023 07:00:00	1:00:00	67,6	91,6	79,4	67,8	66,2	63,3	62,7	61,6	56,4
14/11/2023 07:00:00	14/11/2023 08:00:00	1:00:00	69,4	79,2	70,9	70,5	69,4	68,1	67,5	66,6	62,8
14/11/2023 08:00:00	14/11/2023 09:00:00	1:00:00	69,9	78,7	72,4	70,8	69,9	69,1	69,0	68,2	65,4
14/11/2023 09:00:00	14/11/2023 09:48:07	0:48:07	68,9	80,3	71,5	69,9	68,7	68,0	67,6	67,1	64,6
<b>Note</b>	Le fasce orarie senza livelli sonori, ove presenti, corrispondono a condizioni meteorologiche non accettabili; i livelli equivalenti tengono conto delle misure eliminate a causa delle condizioni meteorologiche critiche. Le celle evidenziate in grigio riportano i dati riferiti al periodo notturno.										

RISULTATI DELLE MISURE											
Ora inizio	Ora termine	Durata hh:mm	La <sub>eq</sub> [dB]	LAF <sub>max</sub> [dB]	LA <sub>1</sub> [dB]	LA <sub>10</sub> [dB]	LA <sub>50</sub> [dB]	LA <sub>90</sub> [dB]	LA <sub>95</sub> [dB]	LA <sub>99</sub> [dB]	LAF <sub>min</sub> [dB]
13/11/2023 10:00:00	13/11/2023 22:00:00	7:00:00	69,4	94,5	79,9	69,9	67,9	64,4	63,5	62,3	55,5
14/11/2023 06:00:00	14/11/2023 09:48:07	3:48:07	69,0	91,6	72,7	70,5	69,0	65,5	64,2	62,4	56,4
13/11/2023 22:00:00	14/11/2023 06:00:00	7:59:00	61,7	79,0	66,4	64,7	61,0	55,2	53,8	52,1	45,7
<b>Periodo diurno</b>		10:48:07	69,3	94,5	79,4	70,3	68,3	64,6	63,7	62,3	55,5
<b>Note</b>	Le fasce orarie senza livelli sonori, ove presenti, corrispondono a condizioni meteorologiche non accettabili; i livelli equivalenti tengono conto delle misure eliminate a causa delle condizioni meteorologiche critiche. Le celle evidenziate in grigio riportano i dati riferiti al periodo notturno.										

ADDENDI CORRETTIVI	
<b>Componenti tonali</b>	In entrambi i tempi di riferimento, diurno e notturno, non è stata individuata la presenza di componenti tonali
<b>Componenti impulsive</b>	In entrambi i tempi di riferimento, diurno e notturno, sono state riscontrate componenti impulsive che non possono essere attribuite in modo univoco a specifiche sorgenti, pertanto non è stato applicato ai valori misurati l'addendo correttivo previsto al punto 15 dell'allegato A del D.M. 16/3/1998.

# STORIA TEMPORALE

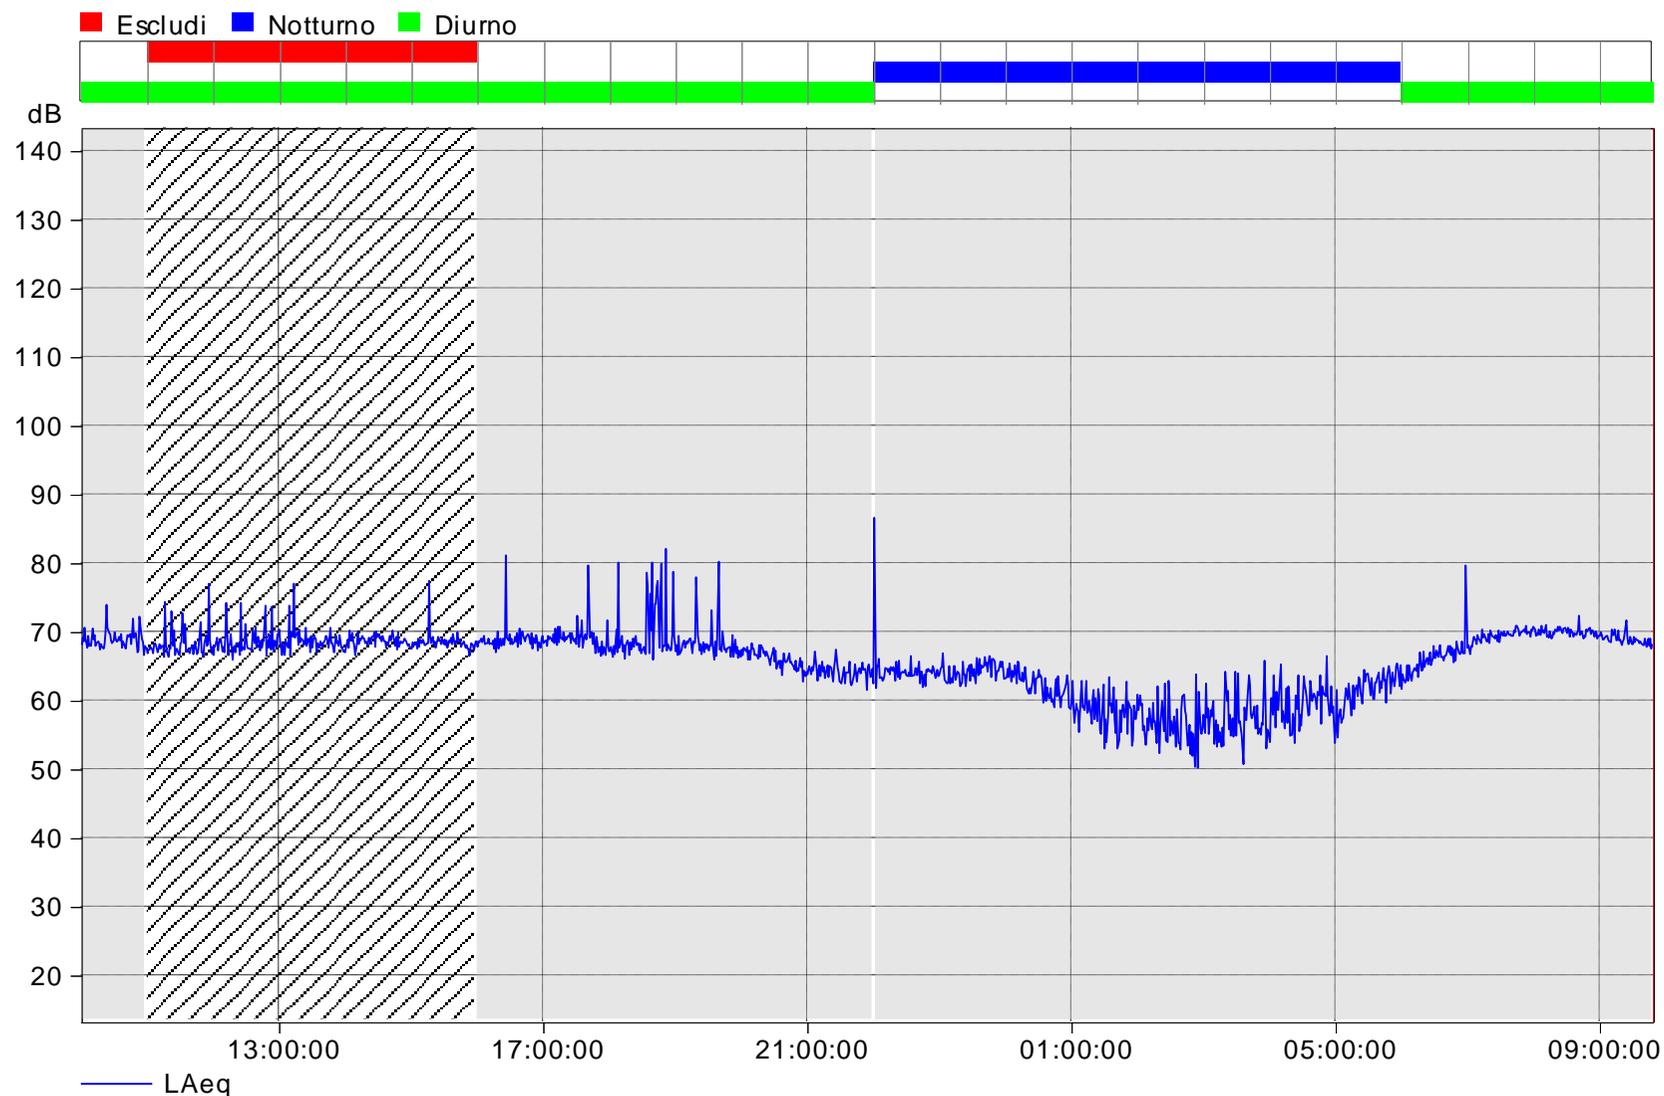

Cursore: 14/11/2023 09:48:00 - 09:49:00 LAeq=68,2 dB LAFmax=70,7 dB LAFmin=67,1 dB

<b>LIMITI APPLICABILI AL RICETTORE</b>					
<b>TR</b>	<b>Livello equivalente misurato</b>		<b>Classificazione Acustica</b>		
	<b>L<sub>Aeq,TR</sub></b>		<b>Classe IV - Aree di intensa attività umana</b>		
			<b>Valore limite di immissione</b>		
Diurno (06-22)	69,5 dB(A)		65 dB(A)		
Notturmo (22-06)	61,5 dB(A)		55 dB(A)		
<b>Infrastrutture di trasporto</b>					
<b>D.P.R. n.142/2004</b>			<b>D.P.R. n.459/1998</b>		
<b>Tipo di strada</b>	-		<b>Tipo infrastruttura</b>	Ferrovia esistente	
<b>Fascia di pertinenza</b>	-		<b>Fascia di pertinenza</b>	-	
<b>Tempo di riferimento</b>	<b>Diurno</b>	<b>Notturmo</b>	<b>Tempo di riferimento</b>	<b>Diurno</b>	<b>Notturmo</b>
<b>Valore limite</b>	-	-	<b>Valore limite</b>	-	-

CONFRONTO CON I RISULTATI DELLA CAMPAGNA ANTE OPERAM E I LIVELLI SOGLIA					
TR	Livello equivalente misurato durante la campagna ante operam	Livello equivalente misurato durante la campagna corso d'opera	Classificazione Acustica Classe IV Aree di intensa attività umana	Livello di Allerta	Livello di allarme
	$L_{Aeq,TR}$	$L_{Aeq,TR}$	Valore limite di immissione	$L_{Aeq}$	$L_{Aeq}$
Diurno (06-22)	67,0 dB(A)	69,5 dB(A)	65 dB(A)	73,0 dB(A)	76,0 dB(A)
Notturmo (22-06)	60,0 dB(A)	61,5 dB(A)	55 dB(A)	65,0 dB(A)	68,0 dB(A)
<b>Note</b>	Per la definizione dei Livelli soglia di rimanda al documento "Proposte di livelli di soglia soglie per la valutazione dei risultati del Monitoraggio Acustico delle attività di cantiere"				

In linea con quanto rilevato durante la campagna ante operam i valori limite di immissione relativi alla classe di appartenenza del ricettore non vengono rispettati nel tempo di riferimento notturno ma sono rispettate le soglie di allerta ed allarme.

Infine, giova sottolineare che le attività si svolgono esclusivamente in periodo diurno, di conseguenza il supero del limite di immissione notturno non è riconducibile al cantiere in esame.

DATI METEOROLOGICI							
Fonte dei dati	Stazione meteorologica SIGE						
Ubicazione	Postazione meteo presso Villa Croce						
data e ora	umidità (%)	pioggia (mm)	temperatura (°C)	pressione (hPa)	direzione media vento (°)	velocità media vento (m/s)	Validazione
13/11/2023 09:00	70,8	0,0	17	1015	183	1,1	Valido
13/11/2023 10:00	73,0	0,0	18	1015	134	3,3	Valido
13/11/2023 11:00	75,6	0,0	17	1014	129	5,6	Non valido
13/11/2023 12:00	79,8	0,0	17	1014	131	5,7	Non valido
13/11/2023 13:00	78,2	0,0	17	1014	122	5,2	Non valido
13/11/2023 14:00	80,5	0,0	17	1014	129	5,1	Non valido
13/11/2023 15:00	83,4	0,0	16	1014	131	5,1	Non valido
13/11/2023 16:00	80,6	0,0	16	1015	127	4,4	Valido
13/11/2023 17:00	77,3	0,0	17	1015	116	2,3	Valido
13/11/2023 18:00	76,1	0,0	17	1015	111	1,4	Valido
13/11/2023 19:00	77,6	0,0	16	1015	161	0,4	Valido
13/11/2023 20:00	78,9	0,0	16	1015	196	0,5	Valido
13/11/2023 21:00	81,0	0,0	15	1015	251	0,8	Valido
13/11/2023 22:00	81,1	0,0	15	1015	250	0,8	Valido
13/11/2023 23:00	81,5	0,0	16	1014	222	1,0	Valido
14/11/2023 00:00	83,3	0,0	16	1014	182	0,8	Valido
14/11/2023 01:00	87,7	0,0	17	1014	121	4,8	Valido
14/11/2023 02:00	89,5	0,0	16	1014	134	4,5	Valido
14/11/2023 03:00	88,4	0,0	16	1014	140	2,5	Valido
14/11/2023 04:00	88,0	0,0	16	1014	134	2,5	Valido
14/11/2023 05:00	85,8	0,0	17	1014	138	2,3	Valido
14/11/2023 06:00	85,4	0,0	17	1014	175	0,8	Valido
14/11/2023 07:00	86,2	0,0	17	1013	126	3,7	Valido
14/11/2023 08:00	87,0	0,0	17	1014	133	4,5	Valido
14/11/2023 09:00	83,2	0,0	18	1014	129	4,1	Valido

<b>TECNICI</b>		
<b>TECNICO</b>	<b>DISPOSITIVO</b>	<b>ENTECA</b>
<b>Alessandro Altomari</b>	Numero atto: 6149 – 2021 Sottoscritto il 13/10/2021 Protocollo NP-2021-322868	11821
<b>Christian Roggerone</b>	Tecnico fonometrista	--

**SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE S.r.l.**

## BIBLIOGRAFIA

- [1] Harris C., Manuale di controllo del rumore, Nuove Tecniche, Milano, 1993.
- [2] ISPRA, Linee Guida per il monitoraggio del rumore derivante dai cantieri di grandi opere, Manuali e linee guida, 101/2013, ISBN: 978-88-448-0634-7
- [3] RTP Ramboll UK Limited e F&M Ingegneria S.p.A., Realizzazione della nuova diga foranea del Porto di Genova nell'ambito del Bacino di Sampierdarena – CUP: C39B18000060006, Piano di Monitoraggio Ambientale P3062-E-AM-G-0003\_01

# Appendice 1 CERTIFICATI DI TARATURA



Microbel S.r.l.  
Corso Primo Levi 23b  
10098 Rivoli (TO)

Centro di Taratura N°213  
Calibration Centre  
Laboratorio Accreditato di  
Taratura



LAT N° 213  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 1 di 8  
Page 1 of 8

## CERTIFICATO DI TARATURA LAT213 23-091-0-SLM Certificate of calibration

- data di emissione <i>date of issue</i>	2023-03-07
- cliente <i>customer</i>	SIGE S.r.l. Via Castel Morrone 15/H 16161 Genova (GE)
- destinatario <i>receiver</i>	SIGE S.r.l. Via Castel Morrone 15/H 16161 Genova (GE)
<u>Si riferisce a</u> <i>referring to</i>	
- oggetto <i>item</i>	Fonometro
- costruttore <i>manufacturer</i>	Brule&Kjaer
- modello <i>model</i>	2250
- matricola <i>serial number</i>	3006391
- data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i>	2023-02-22
- data delle misure <i>date of measurement</i>	2023-03-07
- registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	2023030703

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N. 213 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n.273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

*This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 213 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991, which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.*

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicandole procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura  $k$  corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore  $k$  vale 2.

*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor  $k$  corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor  $k$  is 2.*

Direzione Tecnica  
Approval Officer

Firmato digitalmente da  
ENRICO NATALINI



Microbel S.r.l.  
Corso Primo Levi 23b  
10098 Rivoli (TO)

Centro di Taratura N°213  
Calibration Centre  
Laboratorio Accreditato di  
Taratura



LAT N° 213  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 2 di 8  
Page 2 of 8

CERTIFICATO DI TARATURA LAT213 23-091-0-SLM  
Certificate of Calibration

**Identificazione procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature**  
*Technical procedure used for calibration performed*

ISO 266 (1997): Acoustics -- Preferred frequencies  
IEC 60942 - Ed. 2.0 (1997-11): Electroacoustics - Sound calibrators  
IEC 61672-1 Ed. 2.0 (2013-09) Sound level meters – Part 1: Specifications  
IEC 61672-2 Ed. 2.0 (2013-09) Sound level meters – Part 2: Pattern evaluation tests  
IEC 61672-3 Ed. 2.0 (2013-09) Sound level meters – Part 3: Periodic tests  
I risultati di misura sono stati ottenuti applicando la procedura tecnica PT06 Revisione 1 del 2017-10-27 sviluppata secondo le prescrizioni della norma CEI IEC 61672-3

**Strumenti campioni che garantiscono la riferibilità del Centro**  
*Instruments or measurement standards which guarantee the traceability chain of the Centre*

Strumento	Costruttore	Modello	Numero di serie	Certificato di taratura	Data di taratura	Emesso da
Multimetro digitale	Agilent Technologies	34401A	MY45012922	LAT019-68149	2022-04-09	LAT019 Aviatronik
Calibratore	Norsonic	1253	31050	22-0233-02	2022-03-30	INRIM
Microfono	Bruel&Kjaer	4180	3055394	22-0233-01	2022-03-30	INRIM
Sonda termometrica	Thommen	HM 30	60010066	LAT157 0150 22 TA	2022-03-23	LAT n.157 Allemano Metrology
Sonda igrometrica	Thommen	HM 30	60010066	LAT157 0052 22 UR	2022-03-23	LAT n.157 Allemano Metrology
Sonda barometrica	Thommen	HM 30	1034990	LAT034T 0263P22	2022-03-31	LAT n.034 Galdabini

**Condizioni ambientali e di taratura**  
*Calibration and environmental condition*

Grandezza	Condizioni di riferimento	Condizioni inizio prova	Condizioni fine prova
Pressione atmosferica	101,3 kPa	96,4 kPa	96,4 kPa
Temperatura	23 °C	22,3 °C	22,3 °C
Umidità relativa	50 %	36,9 %	36,9 %



Microbel S.r.l.  
Corso Primo Levi 23b  
10098 Rivoli (TO)

Centro di Taratura N°213  
*Calibration Centre*  
Laboratorio Accreditato di  
Taratura



LAT N° 213  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 3 di 8  
Page 3 of 8

CERTIFICATO DI TARATURA LAT213 23-091-0-SLM  
*Certificate of Calibration*

**Descrizione dell'oggetto di taratura**  
*Description of the item to be calibrated*

Strumento	Costruttore	Modello	Numero di serie
Fonometro	Bruel&Kjaer	2250	3006391
Preamplificatore	Bruel&Kjaer	ZC0032	20396
Microfono	Bruel&Kjaer	4189	2888902

*Firmware del fonometro: 4.7.7.278 - Hw 3.0 - Moduli B27222 e B27223 v. 4.7.7*

*Manuale d'uso del fonometro: User manual*

**Dati omologazione:**

Standard	Classe	Fonte
IEC 61672:2002	1	PTB 21.21/05.02

**Dati tecnici fonometro:**

Frequenza verifica calibrazione	Livello pressione sonora di riferimento	Campo di misura di riferimento
1000 Hz	114 dB	22-139 dB

**Calibratore acustico associato**

Costruttore	Modello	Adattatore	Numero di serie	Ultima taratura
Delta Ohm	HD2020	-	210073652	2023-03-07

**Adattatore capacitivo utilizzato:**

Costruttore	Modello	Capacità
Norsonic	1447/2	18,4 pF

*Origine dati per correzioni microfoniche: User manual*



Microbel S.r.l.  
Corso Primo Levi 23b  
10098 Rivoli (TO)

Centro di Taratura N°213  
*Calibration Centre*  
Laboratorio Accreditato di  
Taratura



LAT N° 213  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 4 di 8  
Page 4 of 8

CERTIFICATO DI TARATURA LAT213 23-091-0-SLM  
*Certificate of Calibration*

**Incertezza estesa**  
*Expanded uncertainties*

Prova	Campo di frequenza	Incertezza
Ponderazione di frequenza con segnali acustici	31,5 Hz	0,52 dB
	63 Hz	0,48 dB
	125 Hz	0,46 dB
	250 Hz	0,42 dB
	500 Hz - 2 kHz	0,41 dB
	4 kHz	0,48 dB
	8 kHz	0,67 dB
	12,5 kHz	0,80 dB
16 kHz	0,86 dB	
Ponderazione di frequenza con segnali elettrici	63 Hz	0,20 dB
	125 Hz - 250 Hz	0,18 dB
	500 Hz - 4 kHz	0,16 dB
	8 kHz - 16 kHz	0,18 dB
Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz	31,5 Hz - 16 kHz	0,15 dB
Stabilità a lungo termine	1 kHz	0,10 dB
Linearità campo primario	8 kHz	0,14 dB
Linearità campi secondari	1 kHz	0,14 dB
Risposta treni d'onda	4 kHz	0,19 dB
Rivelatore di picco C	500 Hz e 8 kHz	0,20 dB
Stabilità ad alti livelli	1 kHz	0,10 dB
Indicatore sovraccarico	4 kHz	0,21 dB



Microbel S.r.l.  
Corso Primo Levi 23b  
10098 Rivoli (TO)

Centro di Taratura N°213  
*Calibration Centre*  
Laboratorio Accreditato di  
Taratura



LAT N° 213  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 5 di 8  
Page 5 of 8

CERTIFICATO DI TARATURA LAT213 23-091-0-SLM  
*Certificate of Calibration*

### Risultati delle tarature *Calibration results*

#### Regolazione sensibilità catena fonometrica

Livello di pressione sonora		
Applicato	Letture ante regolazione	Letture post regolazione
93,9 dB	94,2 dB	93,9 dB
Correzione applicata -0,3 dB (Sensibilità 48,61 mV/Pa)		

#### MISURE ACUSTICHE

##### ACOUSTICAL MEASUREMENTS

#### Verifica del rumore autogenerato

##### *Self generated noise*

Parametro	Ponderazione	Livello misurato dB(A)	Incertezza di misura dB
Leq	A	18,6	±2,4

#### Verifica risposta in frequenza

##### *Acoustical frequency weighting*

Livello di riferimento: 114 dB

Frequenza Hz	Scarto dB	Incertezza di misura dB	Tolleranza classe 1 dB
125	0	0,46	±1,5
1000	0	0,41	±1,1
8000	-0,3	0,48	±1,1



Microbel S.r.l.  
Corso Primo Levi 23b  
10098 Rivoli (TO)

Centro di Taratura N°213  
*Calibration Centre*  
Laboratorio Accreditato di  
Taratura



LAT N° 213  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 6 di 8  
Page 6 of 8

CERTIFICATO DI TARATURA LAT213 23-091-0-SLM  
*Certificate of Calibration*

**MISURE ELETTRICHE**  
*ELECTRICAL MEASUREMENTS*

**Verifica del rumore autogenerato**  
*Self generated noise*

<i>Parametro</i>	<i>Ponderazione A</i>	<i>Ponderazione C</i>	<i>Ponderazione Z</i>	<i>Incertezza di misura</i>
Leq	14,5 dB(A)	17,3 dB(C)	24,0 dB(Z)	±1,4 dB

**Verifica risposta in frequenza**  
*Electrical frequency weighting*

Livello di riferimento: 114,0 dB

<i>Frequenza Hz</i>	<i>Ponderazione</i>			<i>Incertezza di misura dB</i>	<i>Tolleranza classe 1 dB</i>
	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>Z</i>		
63	0	0	0	0,20	±1,5
125	0	0	0	0,20	±1,5
250	-0,1	0	0	0,20	±1,4
500	-0,1	0	0	0,20	±1,4
1000	0	0	0	0,20	±1,1
2000	0	0,1	0	0,20	±1,6
4000	0,1	0,1	0,1	0,20	±1,6
8000	0	0	0	0,20	+2,1/-3,1
16000	2,4	2,4	2,5	0,20	+3,5/-17,0



Microbel S.r.l.  
Corso Primo Levi 23b  
10098 Rivoli (TO)

Centro di Taratura N°213  
Calibration Centre  
Laboratorio Accreditato di  
Taratura



LAT N° 213  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 7 di 8  
Page 7 of 8

CERTIFICATO DI TARATURA LAT213 23-091-0-SLM  
Certificate of Calibration

Verifica ponderazioni in frequenza e costanti temporali a 1kHz  
Frequency and time weighting at 1 kHz

$\Delta$ SPL Fast				Incertezza di misura dB	Tolleranza classe 1 dB
Ponderazione in frequenza					
A	C	Z	Flat		
0	0	0	-	0,20	$\pm 0,4$
Ponderazione temporale			Incertezza di misura dB	Tolleranza classe 1 dB	
Slow		Leq			SEL
0		0	0	0,20	$\pm 0,3$

Linearità nel campo primario  
Level linearity on the reference range

Livello applicato dB	Scarto dB	Incertezza dB	Tolleranza classe 1 dB	Livello applicato dB	Scarto dB	Incertezza dB	Tolleranza classe 1 dB
114	0	0,30	$\pm 1,1$	79	-0,1	0,30	$\pm 1,1$
119	0	0,30	$\pm 1,1$	74	-0,1	0,30	$\pm 1,1$
124	0	0,30	$\pm 1,1$	69	-0,1	0,30	$\pm 1,1$
129	0	0,30	$\pm 1,1$	64	-0,1	0,30	$\pm 1,1$
134	0	0,30	$\pm 1,1$	59	-0,1	0,30	$\pm 1,1$
135	0	0,30	$\pm 1,1$	54	-0,1	0,30	$\pm 1,1$
136	0	0,30	$\pm 1,1$	49	-0,1	0,30	$\pm 1,1$
137	0	0,30	$\pm 1,1$	44	-0,1	0,30	$\pm 1,1$
138	0	0,30	$\pm 1,1$	39	-0,1	0,30	$\pm 1,1$
139	0	0,30	$\pm 1,1$	34	0	0,30	$\pm 1,1$
114	0	0,30	$\pm 1,1$	29	0	0,30	$\pm 1,1$
109	-0,1	0,30	$\pm 1,1$	26	0,2	0,30	$\pm 1,1$
104	-0,1	0,30	$\pm 1,1$	25	0,2	0,30	$\pm 1,1$
99	-0,1	0,30	$\pm 1,1$	24	0,3	0,30	$\pm 1,1$
94	-0,1	0,30	$\pm 1,1$	23	0,4	0,30	$\pm 1,1$
89	-0,1	0,30	$\pm 1,1$	22	0,5	0,30	$\pm 1,1$
84	-0,1	0,30	$\pm 1,1$				



Microbel S.r.l.  
Corso Primo Levi 23b  
10098 Rivoli (TO)

Centro di Taratura N°213  
*Calibration Centre*  
Laboratorio Accreditato di  
Taratura



LAT N° 213  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 8 di 8  
Page 8 of 8

CERTIFICATO DI TARATURA LAT213 23-091-0-SLM  
*Certificate of Calibration*

**Risposta al treno d'onda**  
*Tone burst response*

<i>Costante di tempo</i>	<i>Durata burst ms</i>	$\Delta$ <i>SPL</i>	<i>Incertezza dB</i>	<i>Tolleranza classe 1 dB</i>
F	200	-0,1	0,30	$\pm 0,8$
	2	-0,2	0,30	+1,3/-1,8
	0,25	-0,3	0,30	+1,3/-3,3
S	200	-0,1	0,30	$\pm 0,8$
	2	-0,1	0,30	+1,3/-3,3
SEL	200	-0,1	0,30	$\pm 0,8$
	2	-0,1	0,30	+1,3/-1,8
	0,25	-0,3	0,30	+1,3/-3,3

**Livello di picco "C"**  
*Peak C sound level*

<i>Ciclo</i>	<i>Frequenza Hz</i>	$\Delta$ <i>SPL dB</i>	<i>Incertezza dB</i>	<i>Tolleranza classe 1 dB</i>
Intero singolo	8000	0,2	0,40	$\pm 2,4$
$\frac{1}{2}$ Positivo	500	-0,4	0,40	$\pm 1,4$
$\frac{1}{2}$ Negativo	500	-0,4	0,40	$\pm 1,4$

**Indicazione di sovraccarico**  
*Overload indication*

	<i>Livello misurato dB</i>	<i>Differenza dB</i>	<i>Incertezza dB</i>	<i>Tolleranza classe 1 dB</i>
Indicazione overload semi ciclo positivo	142,7	0,2	0,30	$\pm 1,8$
Indicazione overload semi ciclo negativo	142,9			



Microbel S.r.l.  
Corso Primo Levi 23b  
10098 Rivoli (TO)

Centro di Taratura N°213  
*Calibration Centre*  
Laboratorio Accreditato di  
Taratura



LAT N° 213  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 9 di 8  
Page 9 of 8

CERTIFICATO DI TARATURA LAT213 23-091-0-SLM  
*Certificate of Calibration*

**Stabilità a lungo termine**  
*Long term stability*

	<i>Livello misurato dB</i>	<i>Differenza dB</i>	<i>Incertezza dB</i>	<i>Tolleranza classe 1 dB</i>
Letture iniziale	114,0	0	0,1	±0,1
Letture finale	114,0			

**Stabilità ad alti livelli**  
*High level stability*

	<i>Livello misurato dB</i>	<i>Differenza dB</i>	<i>Incertezza dB</i>	<i>Tolleranza classe 1 dB</i>
Letture iniziale	139,0	0	0,1	±0,1
Letture finale	139,0			

*Il fonometro sottoposto a prova ha superato positivamente i test periodici della IEC 61672-3 alle condizioni ambientali alle quali sono stati effettuati i test. Dato che è disponibile prova, da parte di organizzazione indipendente responsabile per la procedura di omologazione in accordo alla IEC 61672-2, che dimostra che il modello di fonometro soddisfa pienamente i requisiti della IEC 61672-1, il fonometro sottoposto a verifica soddisfa i requisiti per la classe 1 della IEC 61672-1*



Microbel S.r.l.  
Corso Primo Levi 23b  
10098 Rivoli (TO)

Centro di Taratura N°213  
Calibration Centre  
Laboratorio Accreditato di  
Taratura



LAT N° 213  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 1 di 3  
Page 1 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT213 23-094-0-SSR  
Certificate of calibration

- data di emissione <i>date of issue</i>	2023-03-07	Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N. 213 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n.273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.
- cliente <i>customer</i>	SIGE S.r.l. Via Castel Morrone 15/H 16161 Genova (GE)	
- destinatario <i>receiver</i>	SIGE S.r.l. Via Castel Morrone 15/H 16161 Genova (GE)	
<u>Si riferisce a</u> <i>referring to</i>		
- oggetto <i>item</i>	Calibratore	
- costruttore <i>manufacturer</i>	Delta Ohm	
- modello <i>model</i>	HD2020	<i>This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 213 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.</i>
- matricola <i>serial number</i>	21007365	
- data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i>	2023-02-22	
- data delle misure <i>date of measurement</i>	2023-03-07	
- registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	2023030706	

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicandole procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.  
*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.  
*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.*

La Direzione Tecnica  
Approval officer

Firmato digitalmente da

ENRICO NATALINI



Microbel S.r.l.  
Corso Primo Levi 23b  
10098 Rivoli (TO)

Centro di Taratura N°213  
*Calibration Centre*  
Laboratorio Accreditato di  
Taratura



LAT N° 213  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 2 di 3  
Page 2 of 3

Certificato di Taratura LAT213 23-094-0-SSR  
Certificate of Calibration

**Descrizione dell'oggetto di taratura**  
*Description of the item to be calibrated*

Strumento	Costruttore	Modello	Numero di serie
Calibratore	Delta Ohm	HD2020	21007365

**Identificazione procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature**  
*Technical procedure used for calibration performed*

IEC 60942 - Ed. 3.0 (2003-01): Electroacoustics - Sound calibrators  
IEC 60942-am1 - Ed. 2.0 (2000-10): Amendment 1  
I risultati di misura sono stati ottenuti applicando la procedura tecnica PT02 Revisione 7 emessa in data 2020-07-02.

**Campioni di prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilità del Centro**  
*Reference standards from which traceability chain is originated in the Centre*

Strumento	Costruttore	Modello	Numero di serie	Certificato di taratura	Data di taratura	Emesso da
Multimetro digitale	Agilent Technologies	34401A	MY45012922	LAT019-68149	2022-04-09	LAT019 Aviatronik
Calibratore	Norsonic	1253	31050	22-0233-02	2022-03-30	INRIM
Microfono	Bruel&Kjaer	4180	3055394	22-0233-01	2022-03-30	INRIM
Sonda termometrica	Thommen	HM 30	60010066	LAT157 0150 22 TA	2022-03-23	LAT n.157 Allemano Metrology
Sonda igrometrica	Thommen	HM 30	60010066	LAT157 0052 22 UR	2022-03-23	LAT n.157 Allemano Metrology
Sonda barometrica	Thommen	HM 30	1034990	LAT034T 0263P22	2022-03-31	LAT n.034 Galdabini

**Condizioni ambientali e di taratura**  
*Calibration and environmental condition*

Grandezza	Condizioni di riferimento	Condizioni di prova
Pressione atmosferica	101,3 kPa	96,4 kPa
Temperatura	23,0 °C	22,3 °C
Umidità relativa	50,0 %	36,9 %

Lo strumento è dichiarato dal Costruttore conforme alla classe 1 dello standard IEC 60942:2003



Microbel S.r.l.  
Corso Primo Levi 23b  
10098 Rivoli (TO)

Centro di Taratura N°213  
Calibration Centre  
Laboratorio Accreditato di  
Taratura



LAT N° 213  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 3 di 3  
Page 3 of 3

Certificato di Taratura LAT213 23-094-0-SSR  
Certificate of Calibration

**Risultati delle tarature e loro incertezza estesa**  
*Calibration results and their expanded uncertainties*

**Livello di pressione sonora**

<i>Livello teorico dB</i>	<i>Livello misurato dB</i>	<i>Incertezza dB</i>	<i>Scarto dB</i>	<i>Tolleranza classe 1 dB</i>
94,00	93,94	0,12	-0,06	±0,4
114,00	113,98	0,12	-0,02	±0,4

**Determinazione frequenza**

<i>Frequenza nominale Hz</i>	<i>Frequenza misurata Hz</i>	<i>Incertezza %</i>	<i>Scarto %</i>	<i>Tolleranza classe 1 %</i>
1000,00	1002,69	0,3	0,269	±2

**Distorsione totale**

<i>Livello teorico dB</i>	<i>Distorsione totale %</i>	<i>Incertezza %</i>	<i>Tolleranza classe 1 %</i>
94	0,75	0,2	3
114	0,62	0,2	3