	Gestione e verifica periodica delle apparecchiature	
	Documento di certificazione dello strumento	Rev.00 del 30/06/2014
		Pag. 1 di 2

"Analizzatore Fumi ASG"

Unità Operativa	ALPIQ San Severo
Data: 19/10/2022	Tag strumento: CO
Operazione: <input checked="" type="checkbox"/> Controllo	<input checked="" type="checkbox"/> Ritaratura

Servizio	Analizzatore di CO fumi al camino				
Costruttore	Abb	Matricola:	F-No: 3.350175.9	Modello	URAS 26
Fondoscala	0	/	75	mg/m3	Incertezza 4,000 % f.s.

<u>Strumento Campione</u>					
Controllo / Ritaratura effettuata con Bombola di CO (64,64 mg/Nm3) + NO (224,2 mg/Nm3) + N2 certificata					
N° cert. / Barcode	SIAD 18773 (S1857115)	del	14/07/2021	scadenza	14/07/2023
				Incertezza	1,361 % f.s.
Controllo / Ritaratura effettuata con Bombola N2, (5.0 "RICERCHE", Titolo: 99,999%)					
N° lotto. / Barcode	SIAD S1406316	del	15/11/2021		
				Incertezza	0,001 % f.s.

RAPPORTO TECNICO

	Dati Strumento			Uscita		
Unità Misura	mg/m3			mg/m3		
Campo	0	/	75	0	/	75

Dati del test

		TROVATO		ATTESO			LASCIATO	
		Lettura mg/m3	Errore % f.s.	Riferimento mg/m3	Riferimento % campo	Riferimento mg/m3	Lettura mg/m3	Errore % f.s.
INCR.		1,10	1,47	0,00	0,00	0,00	0,50	0,67
		65,40	1,01	64,64	86,2	64,64	65,00	0,48
DECR.		65,40	1,01	64,64	86,2	64,64	65,00	0,48
		1,10	1,47	0,00	0,00	0,00	0,50	0,67


NOTE:

	Gestione e verifica periodica delle apparecchiature	
	Documento di certificazione dello strumento	Rev.00 del 30/06/2014
		Pag. 2 di 2

"Analizzatore Fumi ASG"

Data: **19/10/2022**

Tag n° : **CO**

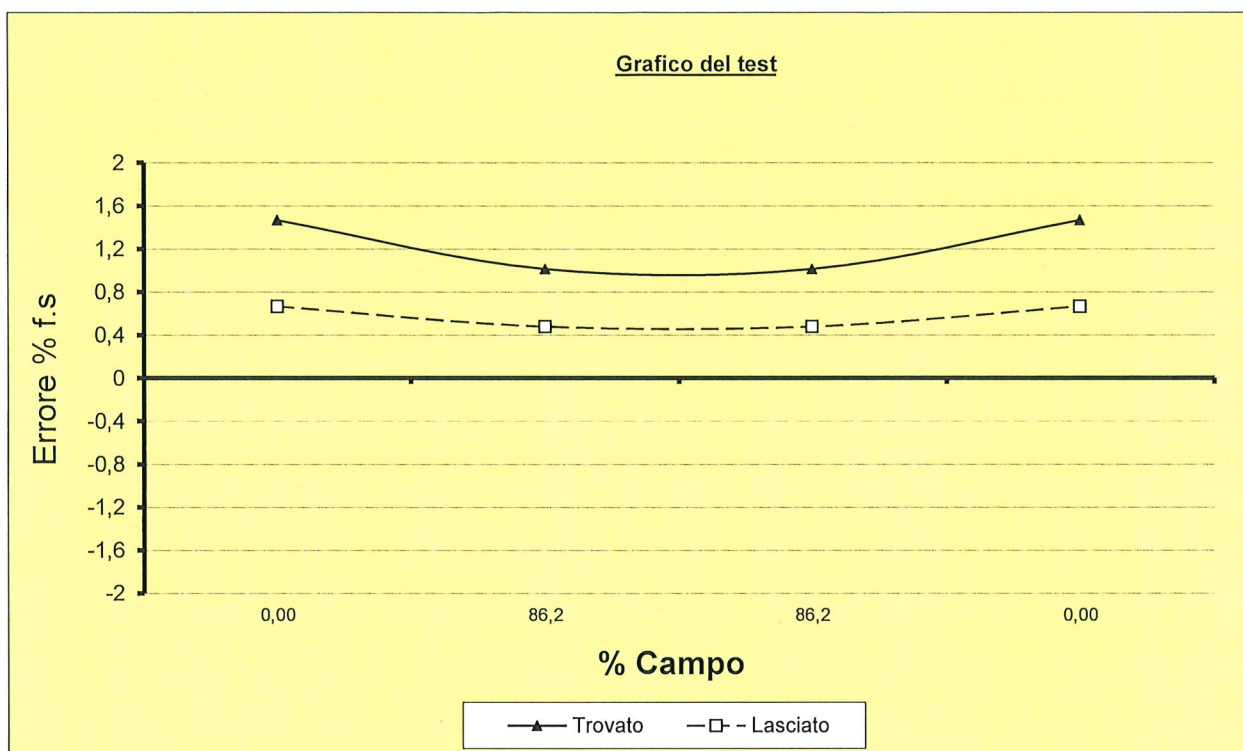

☒ Controllo del loop a valle del ricollegamento dello strumento

(Inserire X quando effettuato)

Errore max rilevato: **0,667** % f.s.

ESITO:

Limite di guardia: **3,812** % f.s.

NEI LIMITI

Limite di accettazione: **4,236** % f.s.

ACCETTATO

Data di esecuzione: **19/10/2022**

Data approvazione: **19/10/2022**

Società: **K.T. Automation**


Società: **ALPIQ**

Operatore: **GALA G.**

Approvazione: **L. Passadore**

Firma.....

Firma.....

	Gestione e verifica periodica delle apparecchiature	
	Documento di certificazione dello strumento	Rev.00 del 30/06/2014
		Pag. 1 di 2

"Analizzatore Fumi ASG"

Unità Operativa	ALPIQ San Severo
Data: 19/10/2022	Tag strumento: NO
Operazione: <input checked="" type="checkbox"/> Controllo	<input checked="" type="checkbox"/> Ritaratura

Servizio	Analizzatore di NO fumi al camino				
Costruttore	Abb	Matricola:	F-No: 3.349610.9	Modello	LIMAS 11 UV
Fondoscala	0	/	250	mg/m3	Incertezza 4,000 % f.s.

Strumento Campione					
Controllo / Ritaratura effettuata con Bombola di CO (64,64 mg/Nm3) + NO (224,2 mg/Nm3) + N2 certificata					
N° cert. / Barcode	SIAD 18773 (S1857115)	del	14/07/2021	scadenza	14/07/2023
				Incertezza	0,981 % f.s.
Controllo / Ritaratura effettuata con Bombola N2, (5.0 "RICERCHE", Titolo: 99,999%)					
N° lotto. / Barcode	SIAD S1406316	del	15/11/2021		
				Incertezza	0,001 % f.s.

RAPPORTO TECNICO

	Dati Strumento			Uscita		
Unità Misura	mg/m3			mg/m3		
Campo	0	/	250	0	/	250

Dati del test

		TROVATO		ATTESO			LASCIATO	
		Lettura mg/m3	Errore % f.s.	Riferimento mg/m3	Riferimento % campo	Riferimento mg/m3	Lettura mg/m3	Errore % f.s.
INCR.		0,60	0,24	0,00	0,00	0,00	0,60	0,24
		224,00	-0,08	224,20	89,7	224,20	224,60	0,16
DECR.		224,00	-0,08	224,20	89,7	224,20	224,60	0,16
		0,60	0,24	0,00	0,00	0,00	0,60	0,24


NOTE:

	Gestione e verifica periodica delle apparecchiature	
	Documento di certificazione dello strumento	Rev.00 del 30/06/2014
		Pag. 2 di 2

"Analizzatore Fumi ASG"

Data: 19/10/2022

Tag n° : NO

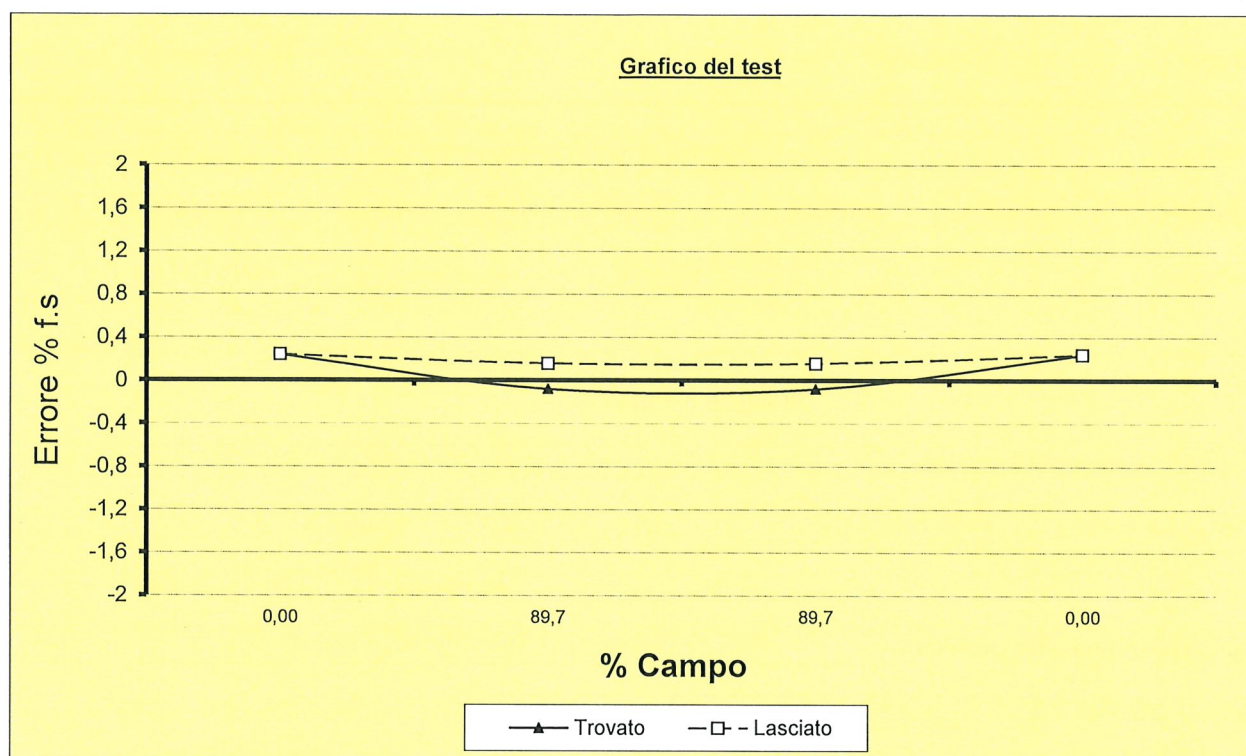

☒ **Controllo del loop a valle del ricollegamento dello strumento** (Inserire X quando effettuato)

Errore max rilevato: 0,240 % f.s.

ESITO:

Limite di guardia: 3,717 % f.s.

NEI LIMITI

Limite di accettazione: 4,129 % f.s.

ACCETTATO

Data di esecuzione: 19/10/2022

Data approvazione: 19/10/2022


Società: K.T. Automation

Società: ALPIQ


Operatore: GALA G.

Approvazione: L. Passadore

Firma



Firma



	Gestione e verifica periodica delle apparecchiature	
	Documento di certificazione dello strumento	Rev.00 del 30/06/2014
		Pag. 1 di 2

"Analizzatore Fumi ASG"

Unità Operativa	ALPIQ San Severo
Data: 19/10/2022	Tag strumento: O2
Operazione: <input checked="" type="checkbox"/> Controllo	<input checked="" type="checkbox"/> Ritaratura

Servizio	Analizzatore di O2 fumi al camino				
Costruttore	Abb	Matricola:	F-No: 3.350176.9	Modello	MAGNOS 206
Fondoscala	0	/	25	% O2	Incertezza 1,560 % f.s.

Strumento Campione					
Controllo / Ritaratura effettuata con		Bombola di O2 (20,90%) + N2 certificata,			
N° cert. / Barcode	SIAD 11073 (S1765702)	del	28/04/2021	scadenza	28/04/2026
				Incertezza	0,170 % f.s.
Controllo / Ritaratura effettuata con		Bombola N2, (5.0 "RICERCHE", Titolo: 99,999%)			
N° lotto. / Barcode	SIAD S1406316	del	15/11/2021		
				Incertezza	0,001 % f.s.


RAPPORTO TECNICO								
		Dati Strumento			Uscita			
Unità Misura		% O2			% O2			
Campo		0	/	25	0	/	25	
Dati del test								
		TROVATO		ATTESO			LASCIATO	
		Lettura % O2	Errore % f.s.	Riferimento % O2	Riferimento % campo	Riferimento % O2	Lettura % O2	Errore % f.s.
INCR.		0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,97	0,28	20,90	83,60	20,90	20,91	0,04
DECR.		20,97	0,28	20,90	83,60	20,90	20,91	0,04
		0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTE:								

	Gestione e verifica periodica delle apparecchiature	
	Documento di certificazione dello strumento	Rev.00 del 30/06/2014
		Pag. 2 di 2

"Analizzatore Fumi ASG"

Data: 19/10/2022

Tag n° : O2

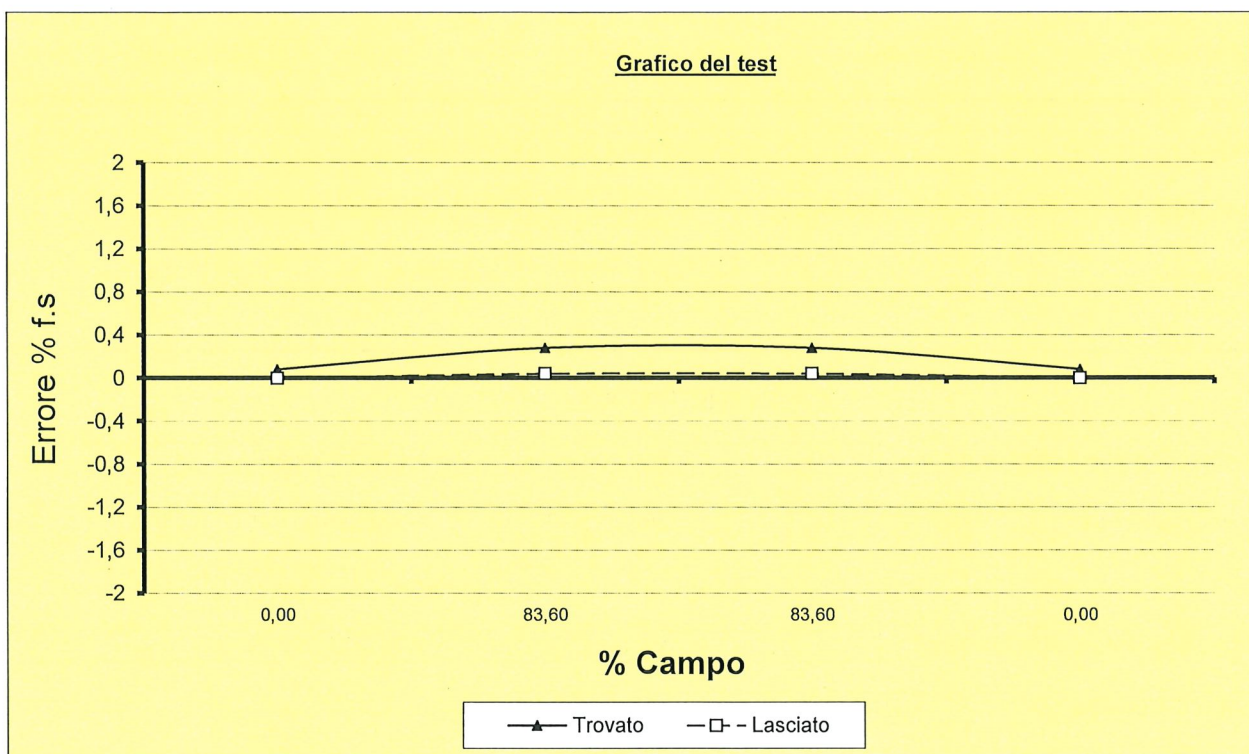

☒ Controllo del loop a valle del ricollegamento dello strumento (Inserire X quando effettuato)

Errore max rilevato: 0,040 % f.s.

ESITO:

Limite di guardia: 1,438 % f.s.

NEI LIMITI

Limite di accettazione: 1,598 % f.s.

ACCETTATO

Data di esecuzione: 19/10/2022

Data approvazione: 19/10/2022

Società: K.T. Automation

Società: ALPIQ

Operatore: GALA G.

Approvazione: L. Passadore

Firma.....

Firma.....